Приложение 6-1 К Правилам закупа услуг у субъектов здравоохранения по оказанию медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования

Заключение по результатам посещения субъекта здравоохранения, претендующего на оказание медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования

город Туркестан "29" октябрь 2025 года
(местонахождение)

Рабочий состав по включение базу данных в составе:

1) Ержанов Абзал Амангельдиевич - руководитель отдела оценки качества медицинской помощи и мониторинга договорных обязательств филиала по Туркестанской области некоммерческого акционерного общества «Фонд социального медицинского страхования»
2) Бекаев Айбол Серикбаевич - главный эксперт Отдела закупа и оплаты медицинской помощи филиала по Туркестанской области некоммерческого акционерного общества «Фонд социального медицинского страхования»

(Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность членов комиссии)

посетивших субъект здравоохранения) в рамках рассмотрения заявки на планируемые объемы медицинских услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования (далее – заявка на планируемые объемы) при проведении процедуры выбора субъектов здравоохранения для размещения объемов услуг на оказание

Экстренная и плановая стоматологическая помощь отдельным категориям граждан РК в системе ОСМС

(указываются виды/формы или условия оказания) услуг (лот) согласно заявке на планируемые объемы)

заявки на включение в базу данных **77698**

(указывается номер объявления) посетила производственную (-ые) базу(-ы)

Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "Denta + SK"
БИН/ИИН 240540031195 (указать наименование субъекта здравоохранения)

по адресу: **Туркестанская область, Сарыагашский район, сельский округ Куркелесский, село Акниет, улица Абай, строение №33А**

(указывается адрес производственной (-ых) баз(-ы))

По результатам посещения РЕШИЛА: Не соответствует

При посещении Товарищества с ограниченной ответственностью **ТОО «Denta + SK»**, расположенного в одноэтажном здании, установлено следующее:

1. **Доступность для лиц с ограниченными возможностями:**
   При входе в производственное помещение имеется пандус, однако его конструкция не соответствует требованиям, установленным для лиц с ограниченными возможностями.
   Данное несоответствие является нарушением требований **приказа Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 21 сентября 2020 года № ҚР ДСМ-106 «Об утверждении перечня отдельных категорий населения, подлежащих экстренной и плановой стоматологической помощи»**.

Вывод:
По результатам проверки установлены нарушения нормативных требований, регулирующих доступность объектов здравоохранения для лиц с ограниченными возможностями, а также требований к оснащению медицинскими изделиями и их регистрации.

Руководитель отдела **Ержанов Абзал Амангельдиевич**

Главный эксперт **Бекаев Айбол Серикбаевич**

Dent
TIS MHANASY
B1-8
Galaxy A32

Dentc+
Galaxy A32

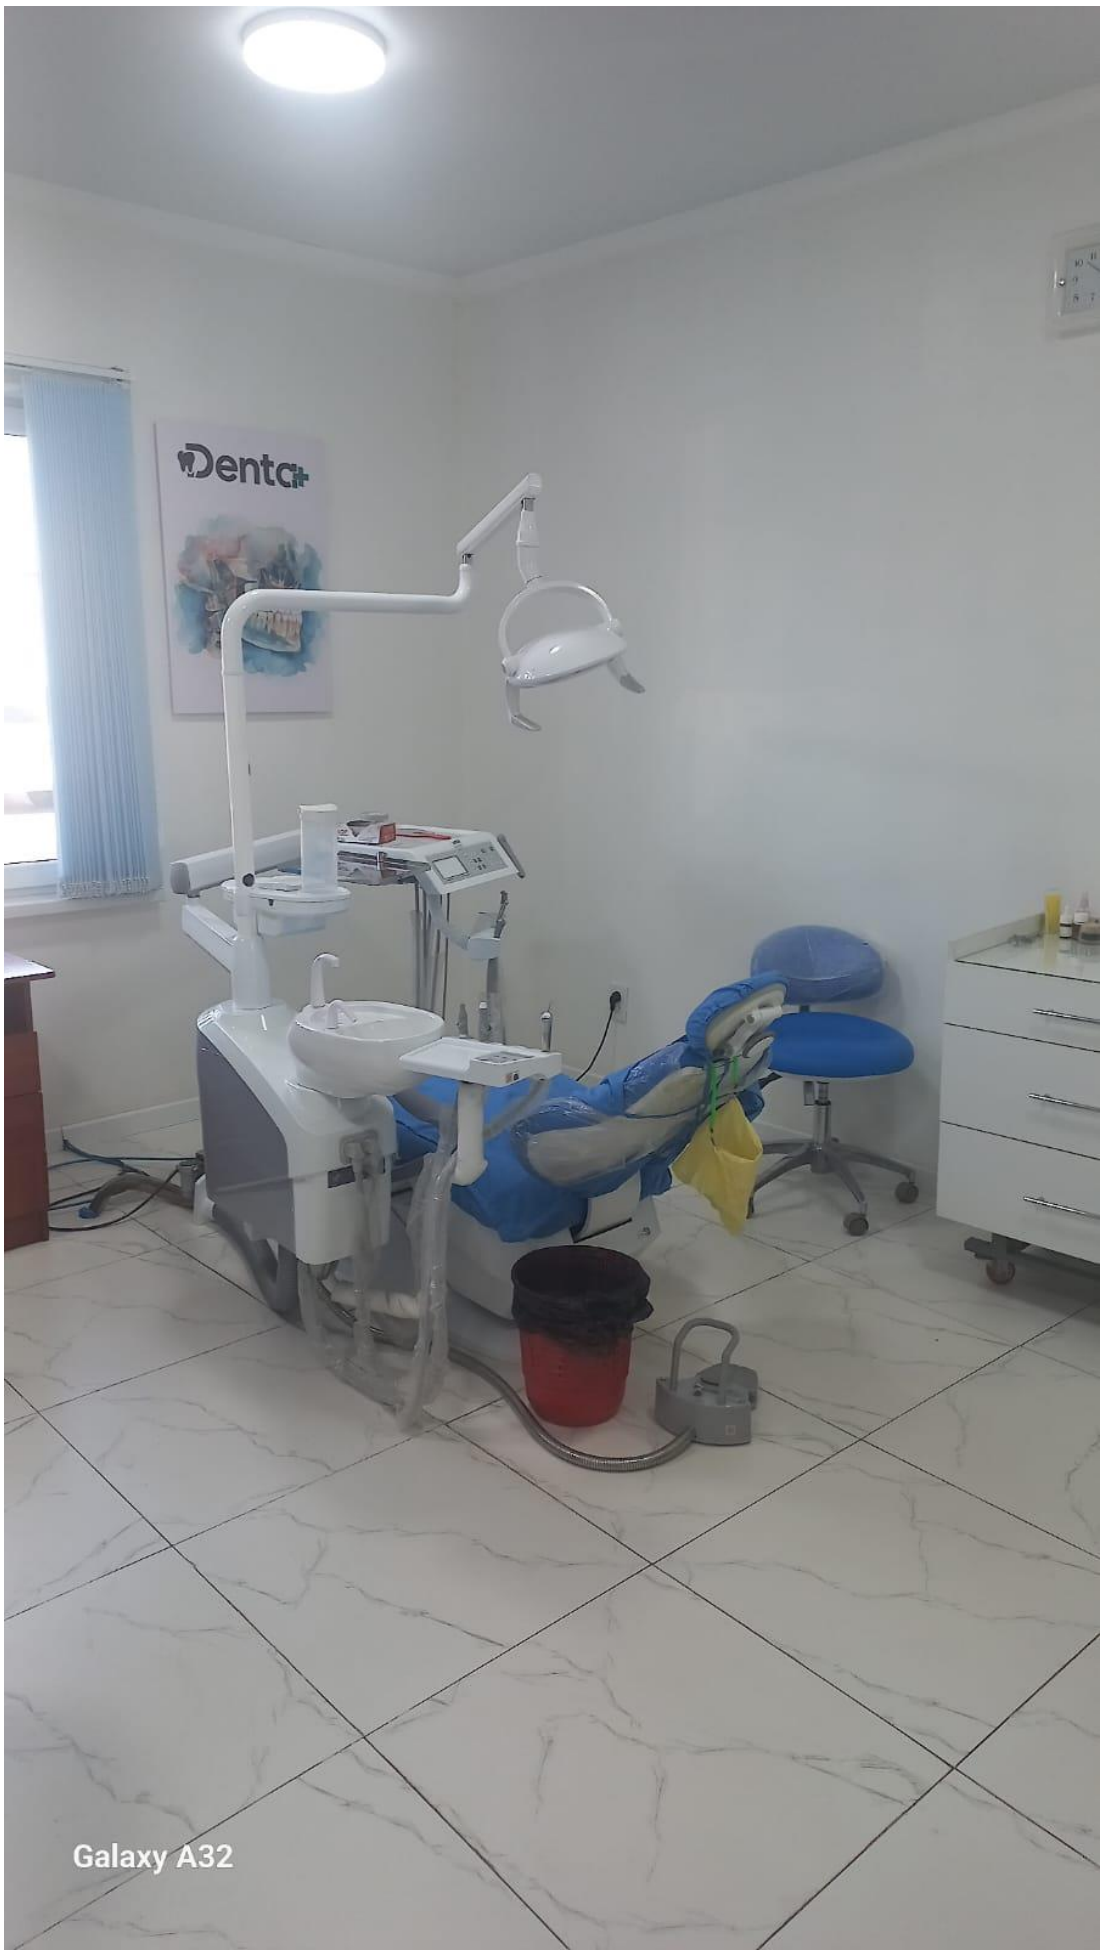
Denta+
Galaxy A32

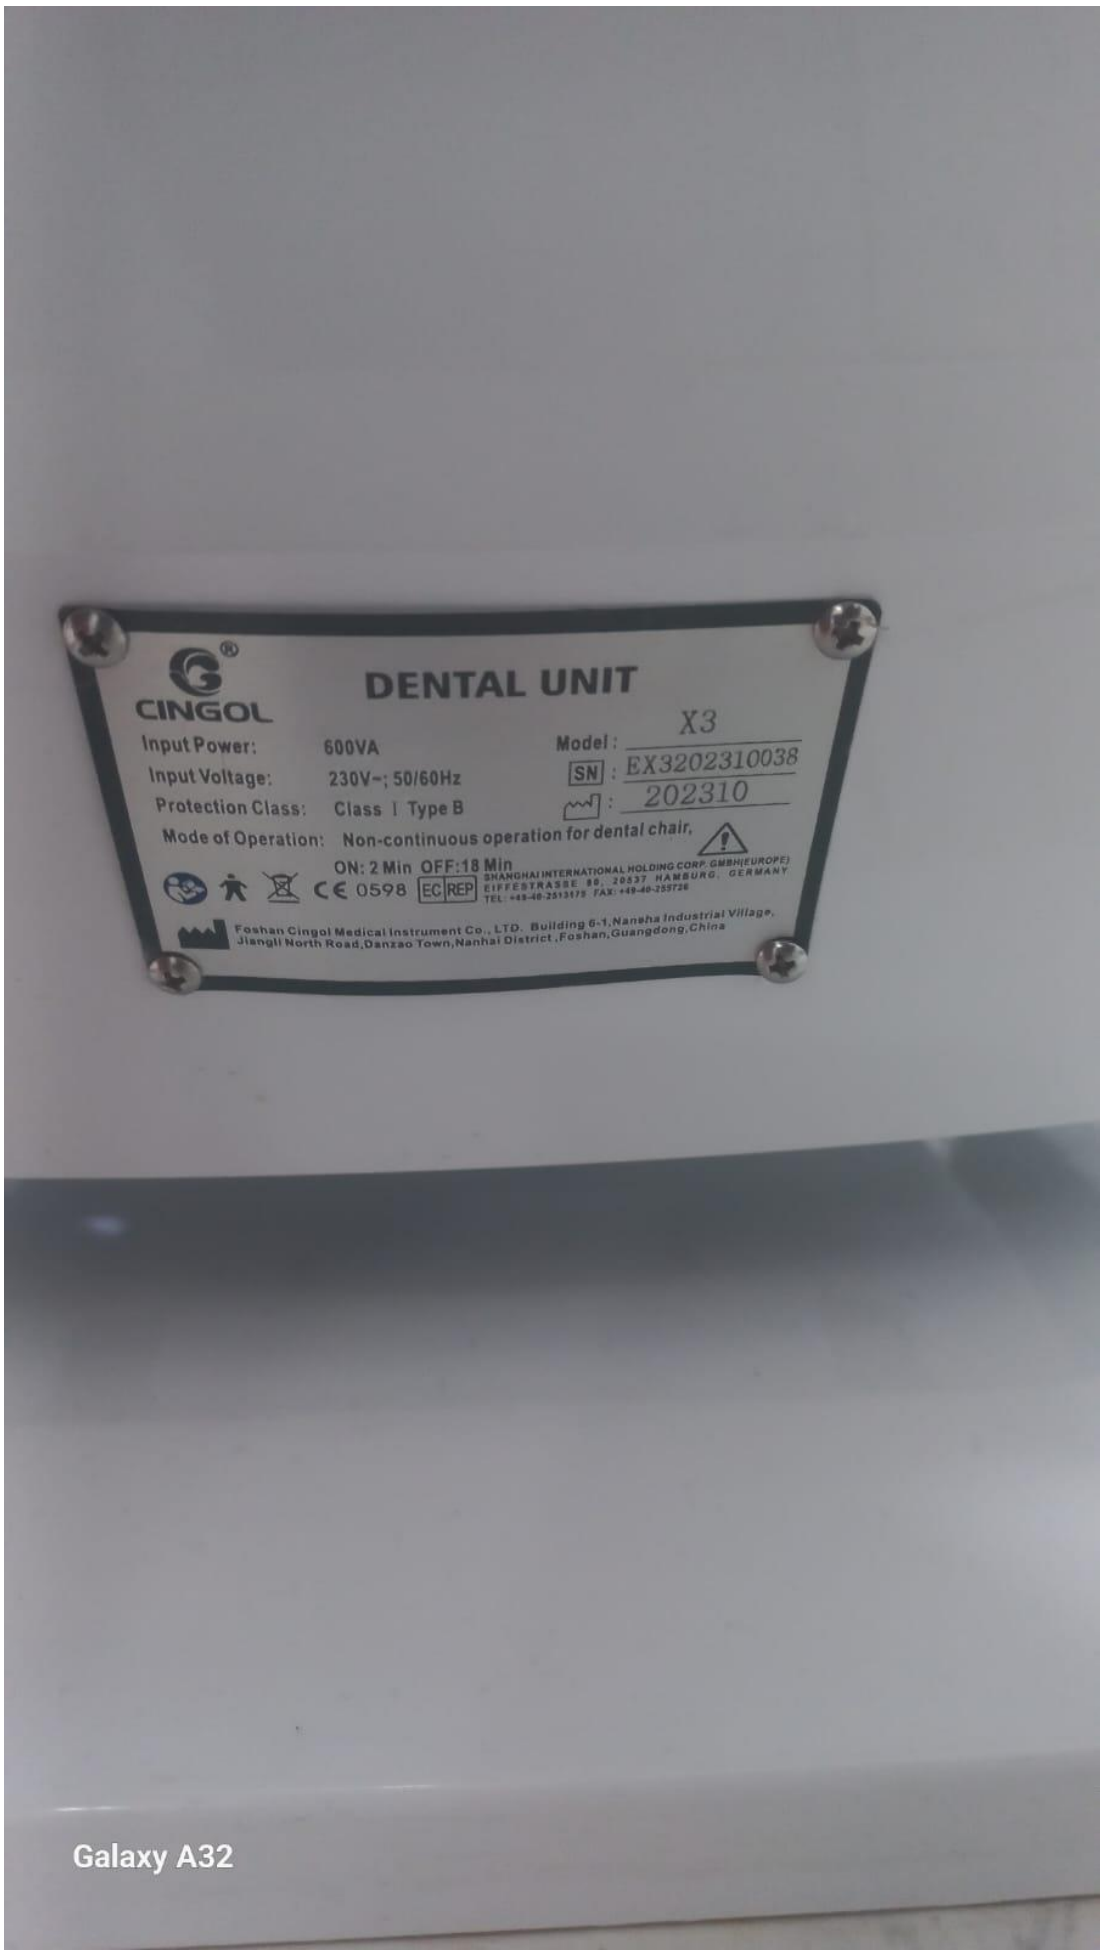
CINGOL
DENTAL UNIT
Input Power: 600VA
Model : X3
Input Voltage: 230V~; 50/60Hz
SN : EX3202310038
Protection Class: Class I Type B
: 202310
Mode of Operation: Non-continuous operation for dental chair.
ON: 2 Min OFF:18 Min
CE 0598 EC REP
SHANGHAI INTERNATIONAL HOLDING CORP. GMBH(EUROPE)
EIFFESTRASSE 80, 20537 HAMBURG, GERMANY
TEL: +49-40-2513175 FAX: +49-40-255726
Foshan Cingol Medical Instrument Co., LTD. Building 6-1,Nansha Industrial Village,
Jiangli North Road,Danzao Town,Nanhai District ,Foshan,Guangdong,China
Galaxy A32

АНАФИЛАКТИКАЛЫҚ ШОК
Galaxy A32

CINGOL
DENTAL UNIT
Input Power: 600VA
Input Voltage: 230V~; 50/60Hz
Protection Class: Class I Type B
Mode of Operation: Non-continuous operation for dental chair,
ON: 2 Min OFF:18 Min
Model : X3
SN : EX3202310037
: 202310
CE 0598 EC REP
Foshan Cingol Medical Instrument Co., LTD. Building 6-1,Nansha Industrial Village,
Jiangli North Road,Dansao Town,Nanhai District ,Foshan,Guangdong,China
Galaxy A32

Galaxy A32

WARNING
Please follow the safety exposure, observe the operation instrution and maintenance plan,Otherwise, the X-ray machine will endanger patients and operators.
Dental X-Ray Equipment
Mondel: RAYO
Input Power:220VAC，50-60Hz，900VA
Serial No.: RN2006A0003
Date:06.2020
CE 0197
Galaxy A32

WARNING
Galaxy A32

2
3
CU
ANALYZE
CHARGE
MONITOR
MENU
ADJUST
Galaxy A32

Galaxy A32
Paramedic CU-ER5
CU Medical Systems, Inc
Dongwha Medical Instrument Complex
1647-1 Dongwha-ri, Munmak-eup, Wonju-si,
Gangwon-do, Republic of Korea
TEL : +82-33-747-7657
FAX : +82-33-747-7659
http://www.cu911.com
SN :
MADE IN KOREA
CAUTION-HAZARDOUS ELECTRICAL OUTPUT
This equipment is for use only by qualified personnel.
CAUTION-ELECTRIC SHOCK HAZARD.
Do not remove cover(or back). Refer servicing to qualified service personnel.
DANGER-Possible explosion hazard if used in the presence of
concentrated oxygen.

Galaxy A32